ASPI CUT - INSTRUMENTO SOMATEX PARA BIÓPSIA

STERILE EO CE 0123

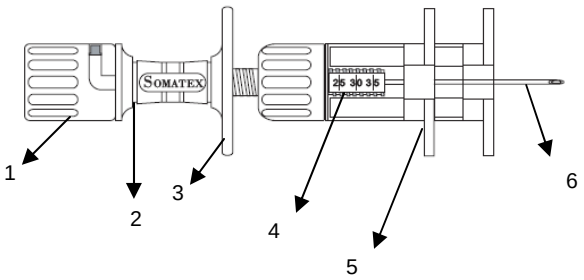

Área de aplicação: Os sistemas de punção da medula óssea ASPI CUT servem para a aspiração da medula óssea através de punção da crista ilíaca posterior ou do externo.

Composição dos produtos (especificação):

	PARTES E COMPONENTES	MATERIAL DE FABRICAÇÃO
1	Tampa de fecho	Policarbonato (PC)
2	Conexão luer lock (para ligação à seringa para aspiração, quando retirada a tampa de fecho)	Plástico ABS (copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno)
3	Pega da cânula de punção	Policarbonato
4	Escala graduada para regulação da profundidade da punção	Policarbonato
5	Ajuste da profundidade da punção	Policarbonato
6	Cânula ou mandril com extremidade perfurante	Aço inoxidável AISI 304

Contra-indicações: hemofilia ou perturbações de coagulação idênticas; infecções na zona do local de punção.

Avisos

- Antes de utilizar o produto familiarize-se com o conteúdo do manual de instruções e leia-o atentamente.
- Utilizar técnica asséptica.
- Só utilizar o dispositivo se a embalagem estiver intacta.
- Os instrumentos foram concebidos para uma única utilização. Eles NÃO devem ser reesterilizados ou reutilizados.
- Nunca utilizar o produto após a expiração do prazo de validade indicado na embalagem.
- Cuidado, perigo de ferimento! Vários elementos destes produtos são muito pontiagudos e podem facilmente causar ferimentos.

Complicações: hemorragias e derramamentos de sangue; infecções; lesões da pele, tecidos moles, nervos ou órgãos vizinhos; perturbações da função respiratória quando são utilizados analgésicos ou calmantes.

Utilização relacionada com a biópsia

1. Assegure-se de que a embalagem não se encontra aberta ou danificada antes do uso; verifique a data de validade.
2. Verifique o tamanho e o formato da cânula conforme indicado na embalagem.
3. Abra a embalagem.
4. Faça anti-sepsia do local de punção e aplique anestésico local na área da punção e nas estruturas subjacentes, se for necessário.
5. Se necessário, faça uma incisão no local de punção com um bisturi pontiagudo para facilitar a penetração na pele.
6. Avançar a cânula de punção até sentir uma resistência ao chegar ao tecido ósseo.
7. Penetrar o tecido ósseo com a cânula através de pressão contínua e efetuando um movimento de rotação (rotação para a direita/para a esquerda).
8. Ao atingir o interior da cavidade (quando a resistência à penetração torna-se menor), retire o trocanter da cânula de punção. Em seguida, deve-se girar o centro do trocanter da cânula em 45º no sentido horário.
9. Conectar a seringa com luer lock à cânula.
10. Aspirar a amostra tracionando o êmbolo da seringa. Se necessário, trocar a seringa e aspirar o volume de medula óssea desejado.
11. Desconetar a seringa e acondicionar a amostra.
12. Depois de terminada a coleta de amostra, remova a cânula através de movimentos de rotação contínuos (rotação para a direita/para a esquerda).
13. Trate o local da punção.
14. Elimine adequadamente a cânula utilizada.

Símbolos	
	Uso único
	Verifique instruções de uso
	Data de fabricação
	Prazo de validade
LOT	Lote
STERILE R	Esterilizado por radiação gama

Importado e Distribuído no Brasil por:
BMR Medical Ltda.
Av. Cândido Hartmann, 570
cj. 174, Curitiba, PR
CNPJ 07.213.544/0001-80
www.bmrmedical.com.br

Fabricado por:
SOMATEX® Medical Technologies GmbH
Rheinstr.7d 14513
Teltow Germany

Registro ANVISA nº: 80299880028
Farmac. Resp. Técnico:
Patrícia Zancanella
CRF/PR 13.683